


SCHWINGGESCHWINDIGKEIT

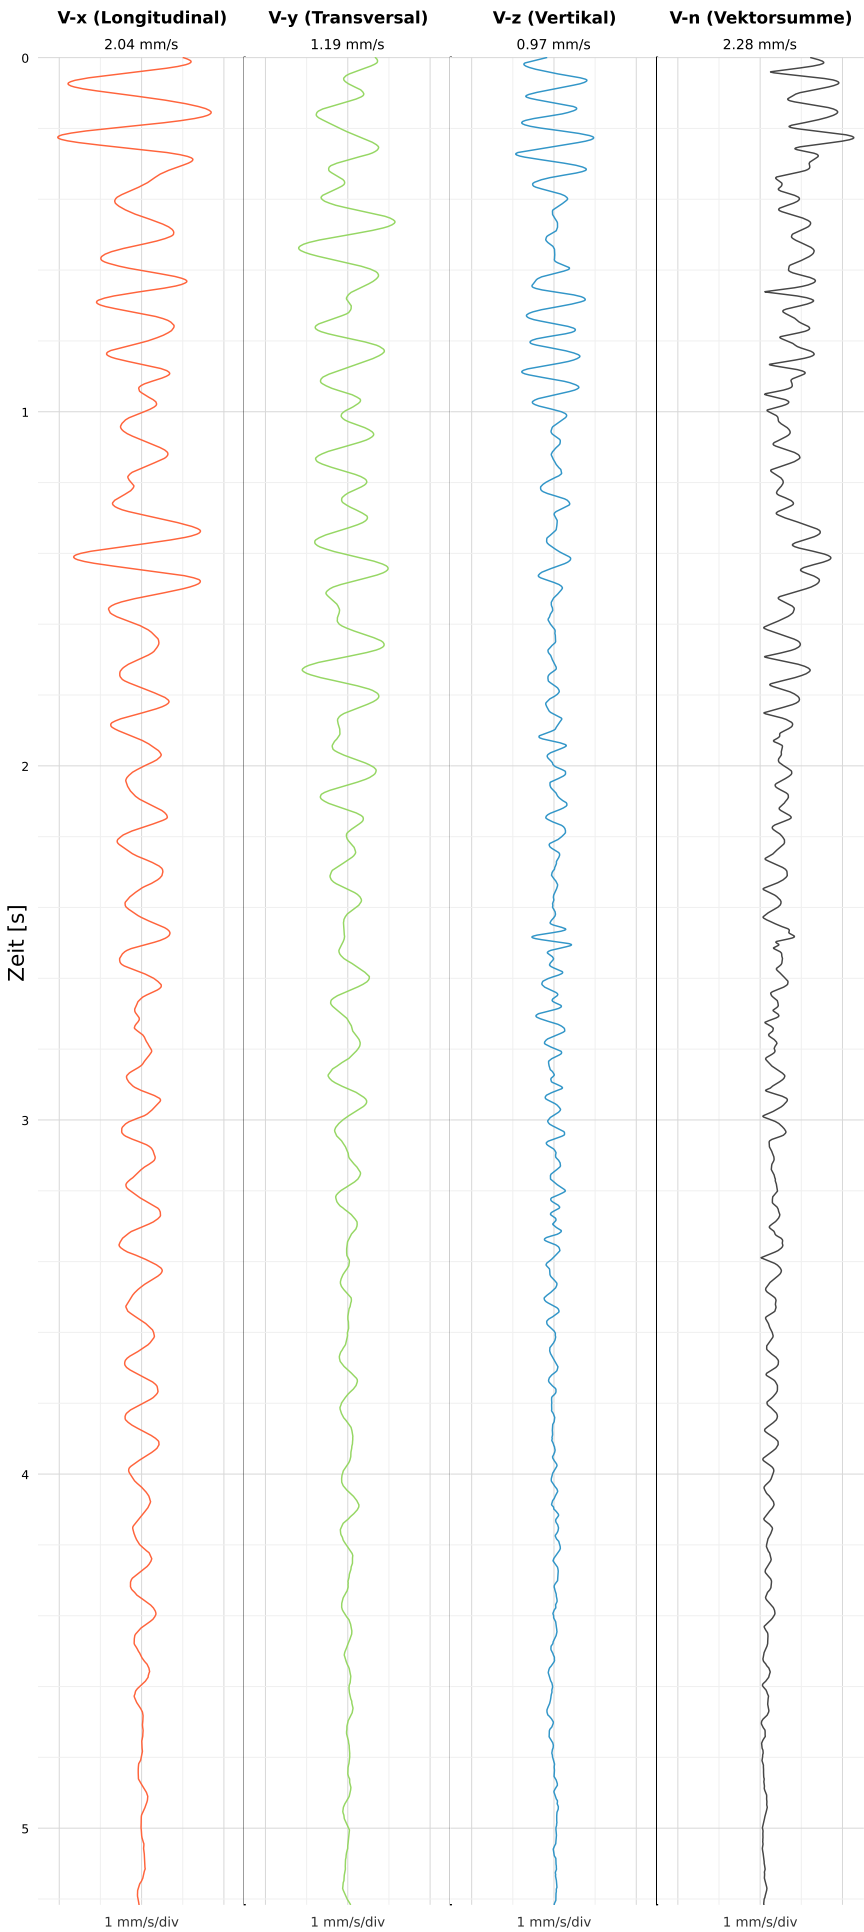


DATEI: 2434-16062026-023903\_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 5.22 s | Abtastrate: 1000 Hz

|                              |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| Datum:                       | 16.06.2026           |                  |
| Zeit:                        | 02:39:03             |                  |
| Event-ID:                    | 2434-16062026-023903 |                  |
| Kalibrier Datum:             | 10.07.2025           |                  |
| Spitzwerte                   |                      |                  |
| V-x (Longitudinal)           | V-y (Transversal)    | V-z (Vertikal)   |
| 2.04 mm/s                    | 1.19 mm/s            | 0.97 mm/s        |
| 6.1 Hz                       | 5.2 Hz               | 12.7 Hz          |
| 40.76% von Limit             | 23.88% von Limit     | 17.07% von Limit |
| V-n (Vektorsumme): 2.28 mm/s |                      |                  |

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

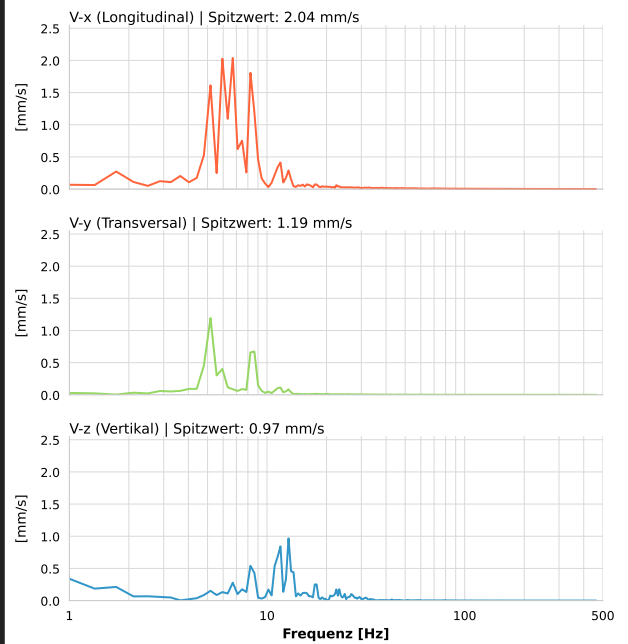

|       |           |              |              |              |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Kanal | Spitzwert | Spektrum 25% | Spektrum 50% | Spektrum 75% |
| X     | 2.04 mm/s | 5.9 Hz       | 8.2 Hz       | 19.0 Hz      |
| Y     | 1.19 mm/s | 5.2 Hz       | 8.2 Hz       | 12.8 Hz      |
| Z     | 0.97 mm/s | 8.6 Hz       | 12.8 Hz      | 19.0 Hz      |

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

